

## 健診結果照会 Web システム説明書

この健診結果照会Web システムは、一般財団法人船員保険会の医療施設（以下「当会」という）および協力医療機関で健康診断を受けられた受診者が、Web 上でご自身の健診結果を照会できるシステムです。

また、当会とデータ管理契約を締結している法人および健康保険組合や事業所等の法人が別途法人利用契約することにより、法人に所属する受診者の健診結果を、契約の範囲内で参照できるサービスも提供できます。

このサイトはセキュリティを高めるため SSL 暗号化通信を利用しています。

### ・ 個人向けサービスのご利用について

健康診断の結果報告書に同封される「健診結果照会 Web システムのご案内」に記載されている URL にアクセスして、仮ユーザーID と仮パスワードを使用してご自身のアカウントを作成していただきます。ご利用いただく前に必ず、「利用規約」をお読みください。

<https://kenshin.sempos.or.jp/> へアクセスして、ご登録いただいたアカウントのユーザーID とパスワードでログインしてご利用ください。

システムの機能として「データ出力／帳票出力」機能をご利用いただくことができますが、帳票出力機能では ActiveX コントロールを使用しています。ブラウザの設定によって

は、ActiveX コントロール実行の許可が必要です。「帳票ソフト ActiveX コントロールの実行について」をご参照ください。

### ・法人向けサービスのご利用について


<https://kenshin.sempos.or.jp/> にアクセスしていただき、ご契約時に設定されたユーザー ID とパスワードでログインします。認証ページでは認証用 USB キーを使用した認証が必要です。

初めて認証用 USB キーをご利用いただく際には、認証用 USB キーのドライバをダウンロード／インストールする必要があります。ブラウザの設定によってはダウンロード／インストールの許可が必要になります。認証用 USB キーを USB ポートに挿す前に「認証用 USB キードライバのダウンロード／インストールについて」をご参照ください。


また、システムの機能として「データ出力／帳票出力」機能をご利用いただくことができますが、帳票出力機能では ActiveX コントロールを使用しています。ブラウザの設定によっては、ActiveX コントロール実行の許可が必要です。「帳票ソフト ActiveX コントロールの実行について」をご参照ください。

## ・ 帳票ソフト ActiveX コントロールの実行について


帳票出力機能を実行すると ActiveX コントロールの実行を確認する警告が表示される場合があります。

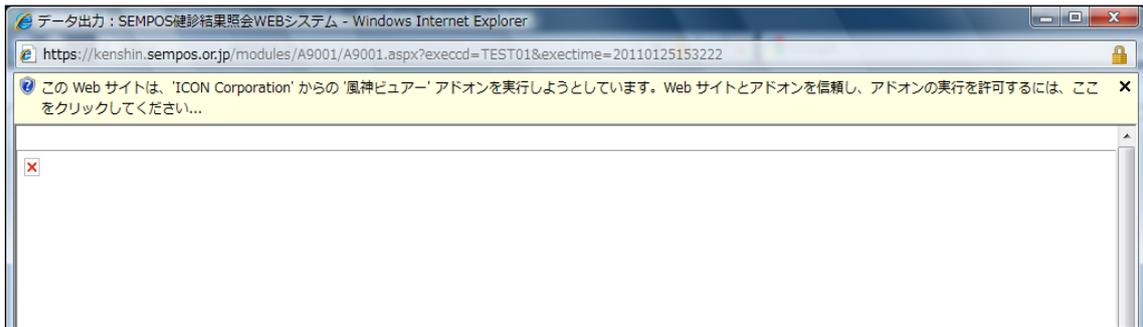

この警告メッセージが表示された場合は、警告メッセージをクリックすると表示されるメニューから「アドオンの実行」をクリックしてください。

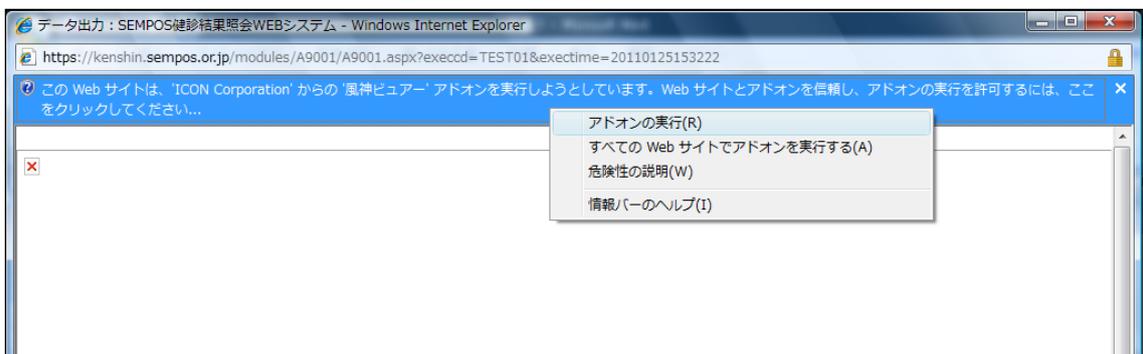

次のような実行確認のダイアログが表示されます。「実行する」をクリックしてください。

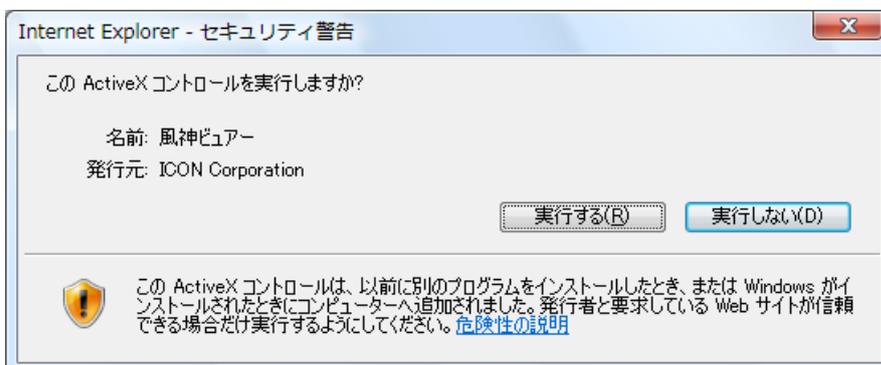



## ・ 認証用 USB キードライバのダウンロード/インストールについて

※認証用 USB キーは必ず USB ポートから外した状態で作業して下さい。

ユーザーID とパスワードを入力して「ログイン」 ボタンを押すと次のような画面になり、


認証用 USB キードライバのインストールを要求します。ブラウザのセキュリティ保護の警

告が表示される場合があります。



この警告メッセージが表示された場合は、警告メッセージをクリックすると表示されるメ

ニューから「ファイルのダウンロード」をクリックしてください。

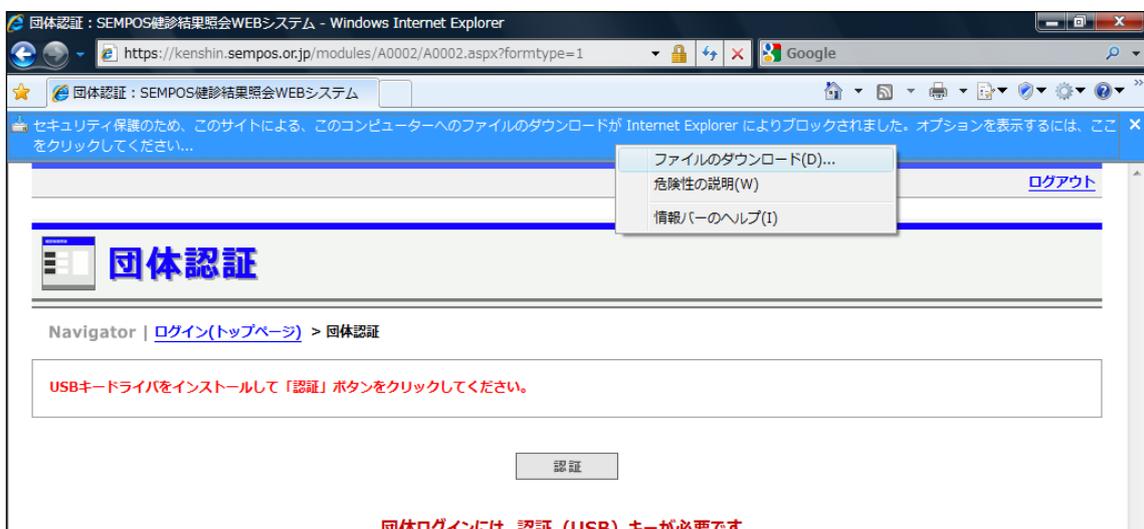

次のようなファイルのダウンロードダイアログが表示されます。




「実行」ボタンでドライバのインストールを実行してください。

次のようなインストールの実行確認ダイアログが表示されます。




「実行する」ボタンをクリックしてインストールを開始してください。


以下のように、インストールの準備を開始します。

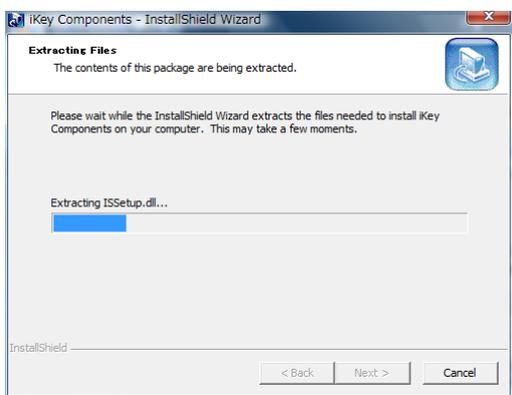


インストールを開始します。次の画面で「Next」ボタンをクリックしてください。

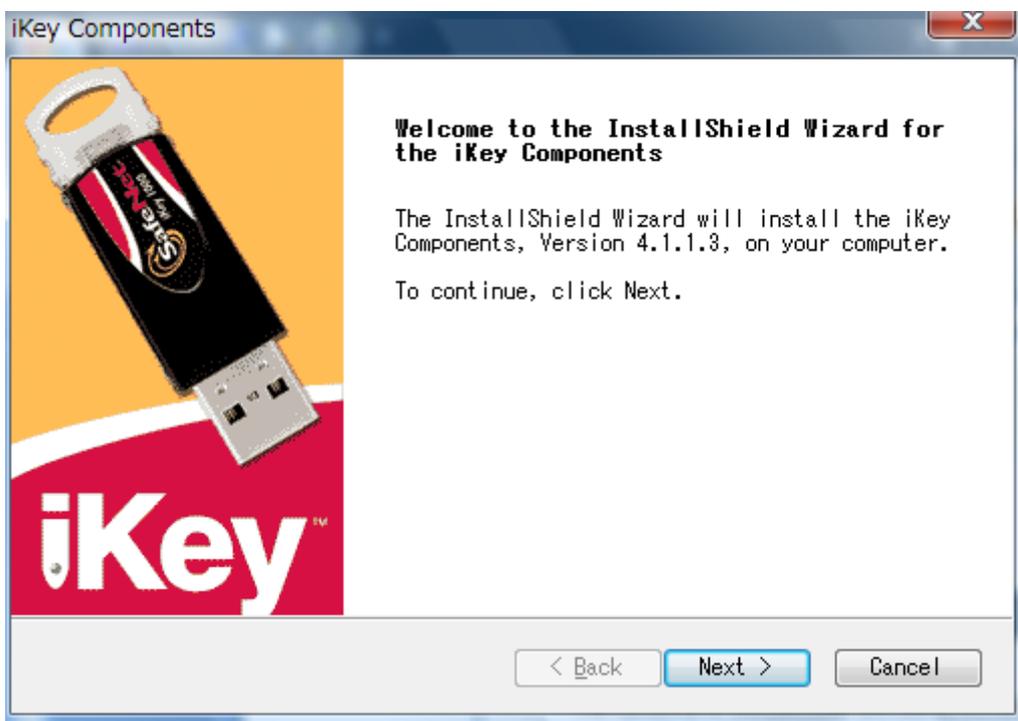


次の画面が表示されます。「Next」ボタンをクリックしてください。

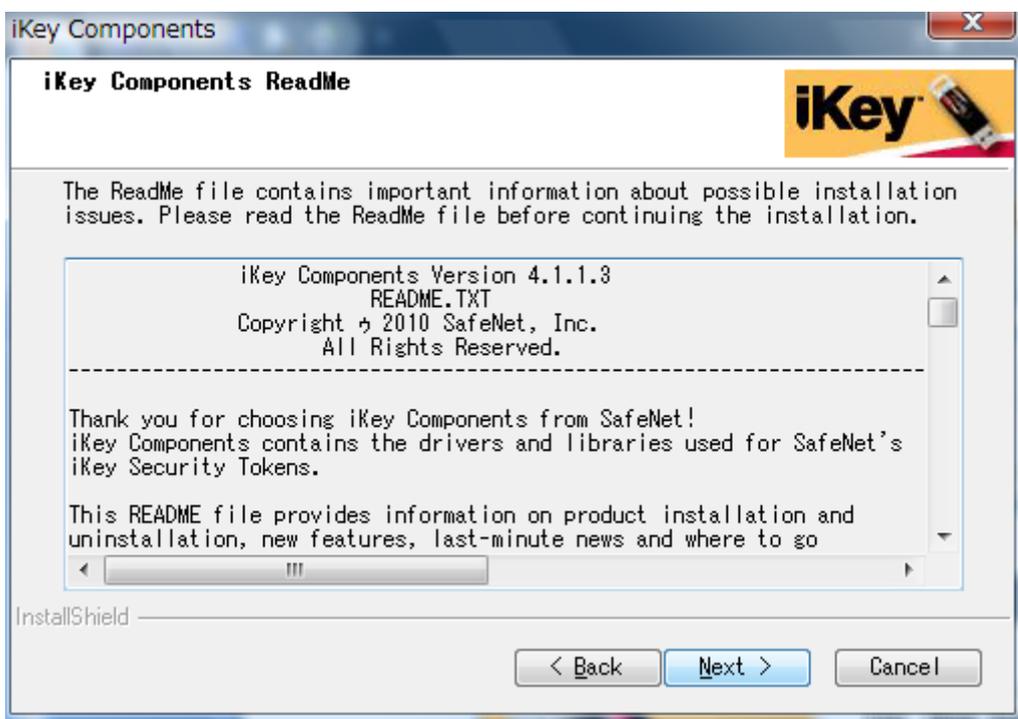


次の画面は認証用 USB キーの利用規約です。お読みいただき問題なければ「Yes」ボタンをクリックしてください。

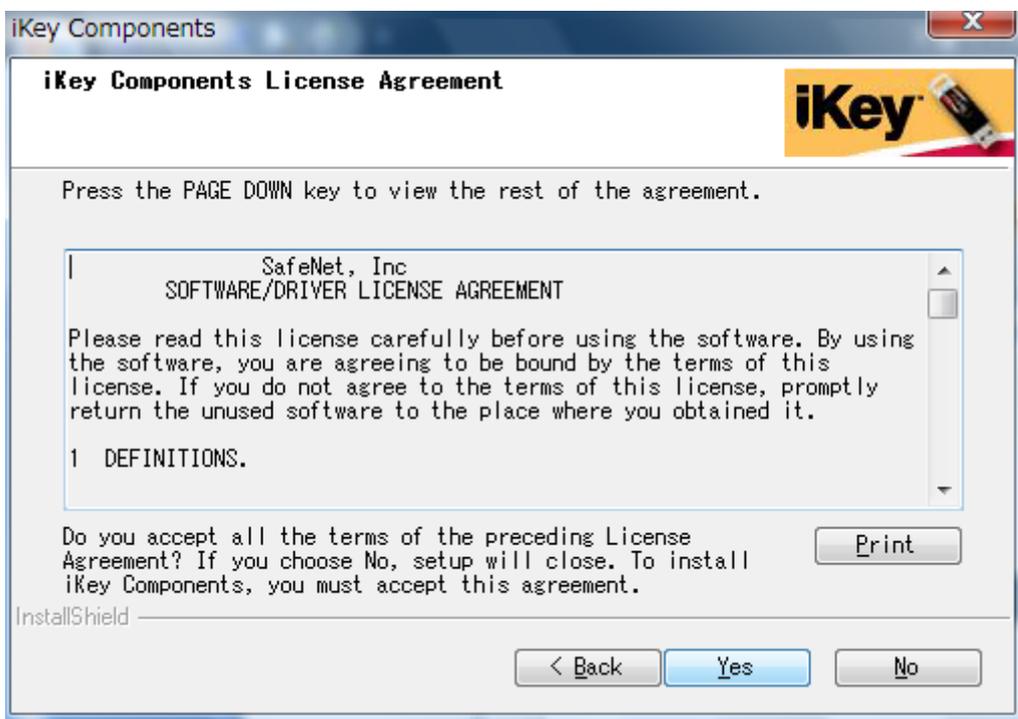

インストールが開始されます。

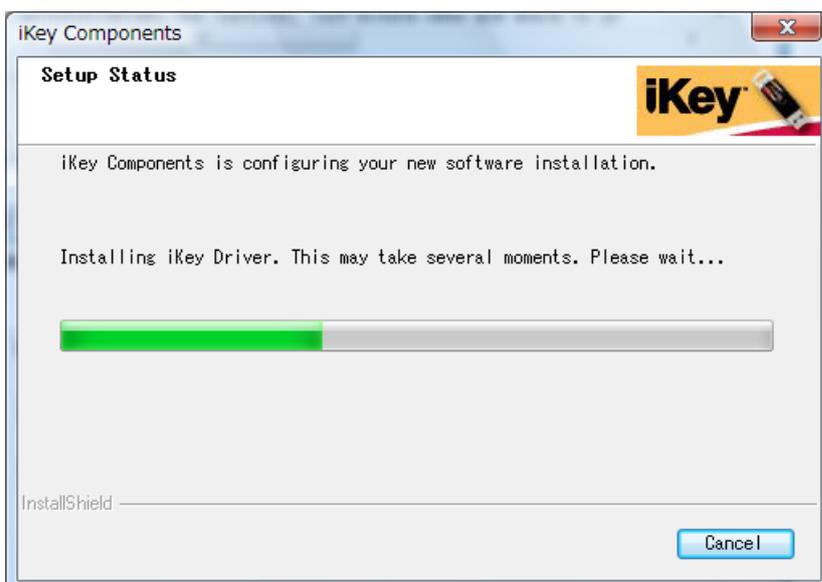


インストール中にいくつかのウィンドウが現れたり消えたりします。

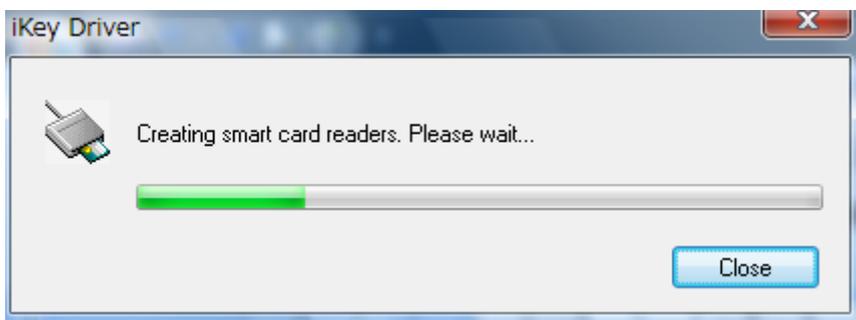

※この時点では認証用 USB キーを USB ポートに挿入しないでください。

下のウィンドウが表示されたら、認証用 USB キーを USB ポートに挿入してください。

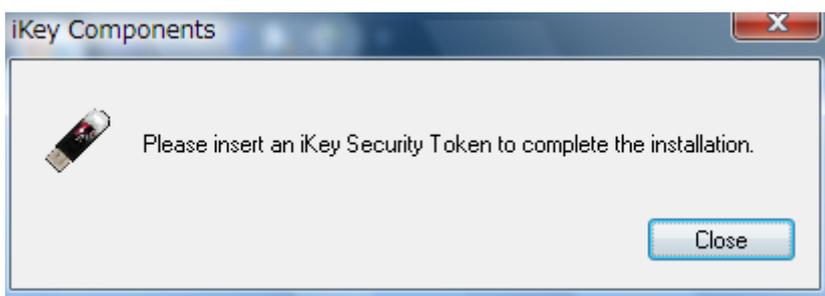

次のウィンドウが表示されインストールは完了です。「finish」ボタンで終了してください。

